



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正本
ORIGINAL

發行日期 Date of Issue: 2023.01.18 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2022.12.30

報告編號 Report No.: TFF1L393 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/3) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 金隆盛企業有限公司(U3543) 試件類別 Item: 口罩


地址 Address: 504 彰化縣秀水鄉鵝鳴村仁義巷16號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
空氣交換壓力差 (mmH ₂ O/cm ²)	1	6.5
	2	6.9
	3	7.5
	4	7.8
	5	7.3
		CNS 14774 T5017-2022 9.4
		CNS 14777 T4039-2003
		流量: 8 (Liter/min)

註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。

註: 空氣交換壓力差測試面積: 4.9 cm²。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 金隆盛立體醫用成人口罩




附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正本
ORIGINAL

發行日期 2023.01.18 收件/試驗起始日期 2022.12.30
Date of Issue: 2023.01.18 Date of Receipt and Test Start: 2022.12.30


報告編號 TFF1L393 數量 1件 報告頁次/頁數 (P3/3) 來文字號 空白
Report No.: TFF1L393 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P3/3) Ref. No.:
報告抬頭 金隆盛企業有限公司(U3543) 試件類別 口罩
Report Title: 金隆盛企業有限公司(U3543) Item: 口罩

地址 504 彰化縣秀水鄉鶴鳴村仁義巷16號
Address: 504 彰化縣秀水鄉鶴鳴村仁義巷16號



- 附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得插錄複製, 但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

正本
ORIGINAL

發行日期 2023.01.18 收件/試驗起始日期 2022.12.30
Date of Issue: 2023.01.18 Date of Receipt and Test Start: 2022.12.30

報告編號 TFF1L393 數量 1件 報告頁次/頁數 (P2/3) 來文字號 空白
Report No.: TFF1L393 Quantity: 1 Page Order/Pages: (P2/3) Ref. No.: 空 白

報告抬頭 金隆盛企業有限公司(U3543) 試件類別 口罩
Report Title: 金隆盛企業有限公司(U3543) Item: 口罩

地址 504 彰化縣秀水鄉鶴鳴村仁義巷16號
Address: 504 彰化縣秀水鄉鶴鳴村仁義巷16號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
細菌過濾效率(%)	1 > 99.9	CNS 14774-T5017-2022 9.2
金黃色葡萄球菌	2 > 99.9	CNS 14775 T4037-2022
ATCC 6538	3 > 99.9	
	4 > 99.9	
	5 > 99.9	

註：對照組的平均菌落數：2833 CFU。


註：平均粒徑：3.1 μm。

註：測試面：外側。

註：測試面積：39.5 cm²。


註：測試流量：28.3 L/min。

註：依委託者所提供來樣資料為：金隆盛立體醫用成人口罩

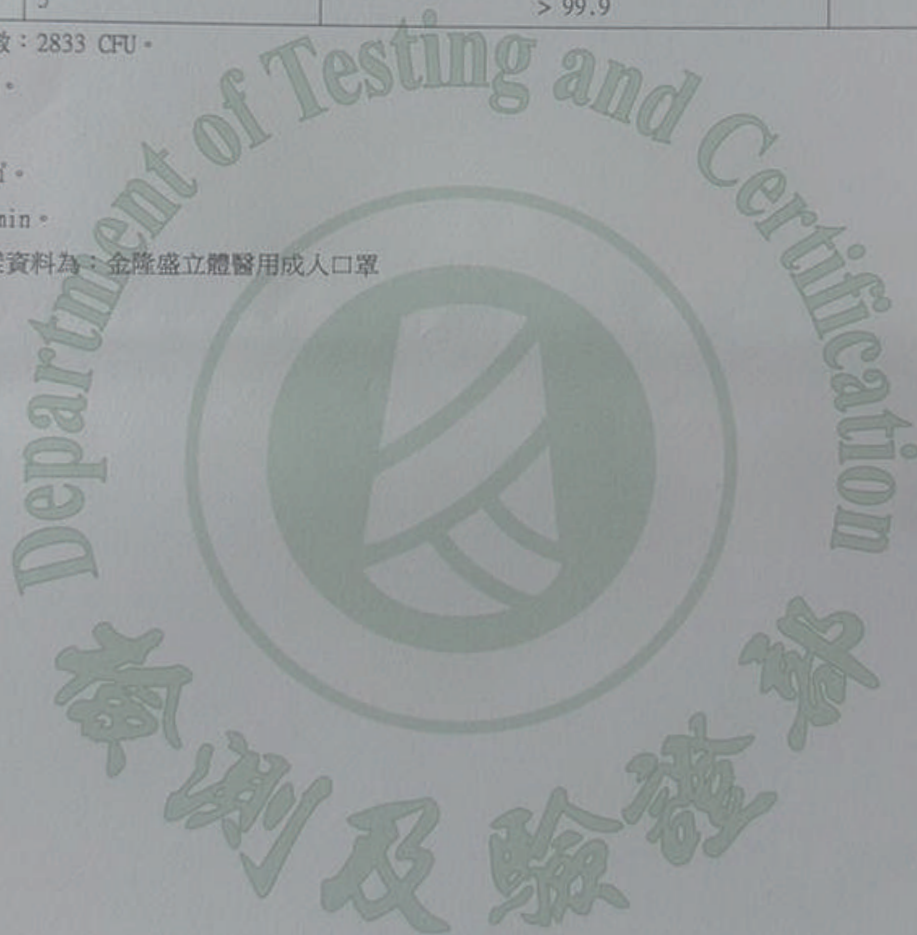

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人：
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839